

iveta

Jméno:

gullichová

Příjmení:

Rodné číslo:

1986-02-02




Datum narození:

Kontaktní informace:

Místo:

2020-06-27

Datum měření:

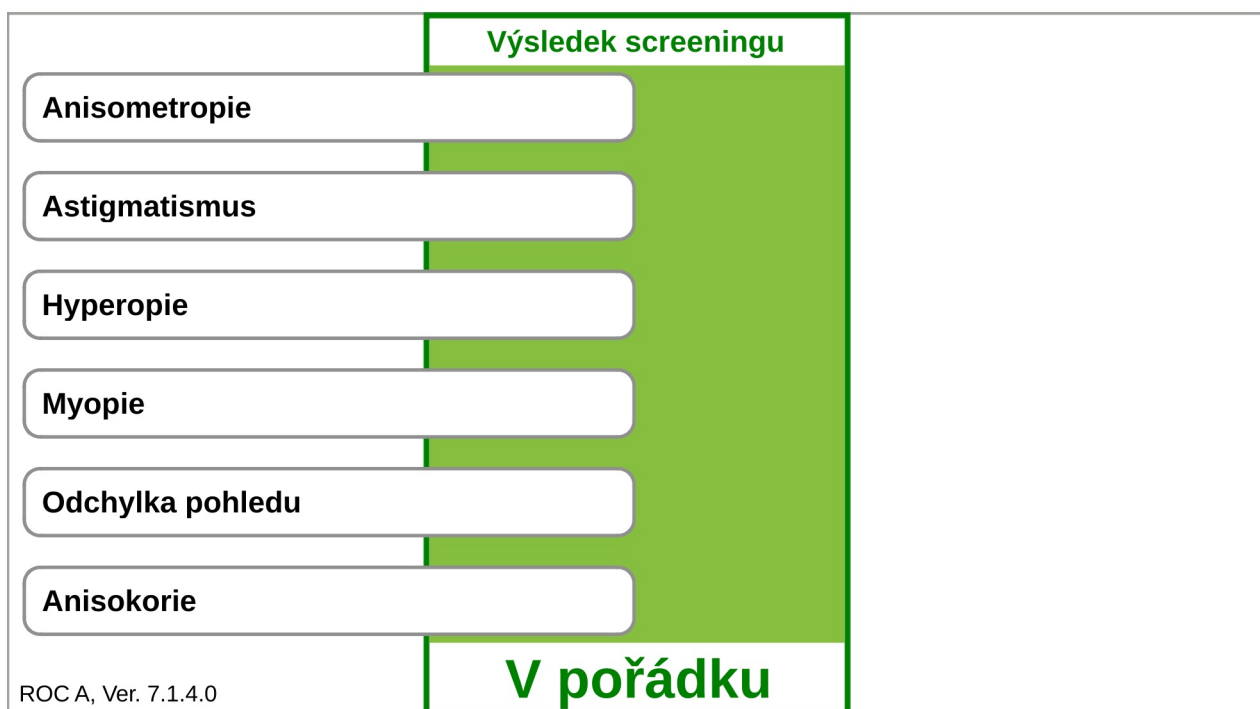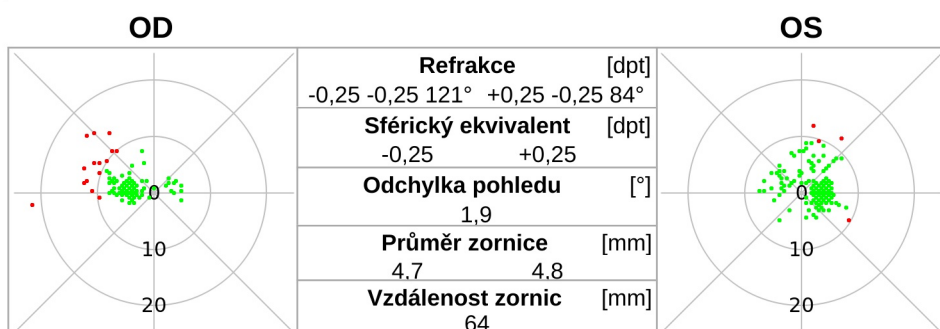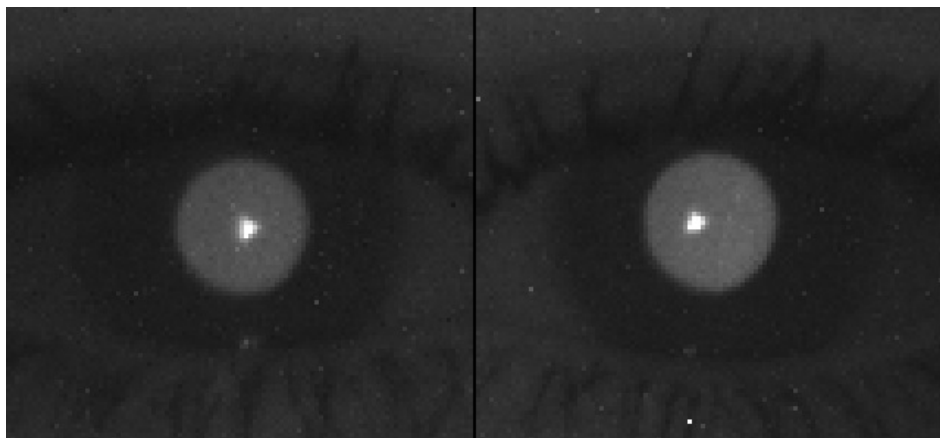

Slouží pouze k měření refrakce bez rozkapání. Naměřené výsledky může hodnotit pouze oční specialista. Vyšetření by mělo být opakováno zhruba v 1/2 ročních intervalech. Děti s výsledkem "Vyšetřit podrobněji" by měly být poslány na podrobné vyšetření oftalmologem.

Refraction was measured with Plusoptix.
Check out our range of binocular autorefractors for your clinic.
www.plusoptix.com



Accurate



Award-winning



Reliable



Compatible